KARTA KATALOGOWA

MULTIMETR CYFROWY MAS838
RĘCZNY WYBÓR ZAKRESÓW

NAJWAŻNIEJSZE CECHY




- Wyświetlacz LCD – 1999 wskazań
- Pomiar napięcia AC/DC do 600 V
- Pomiar prądu stałego do 10 A
- Pomiar rezystancji do 2 MΩ
- Akustyczny test ciągłości obwodu
- Test diod
- Funkcja HOLD
- Sygnalizacja słabej baterii
- Ręczny wybór zakresów pomiarowych
- Zasilanie: 1 bateria 9 V (6F22)


V≅ A⎓ Ω CAT III

HOLD MANUAL 6F22x1

1. BUDOWA I ELEMENTY

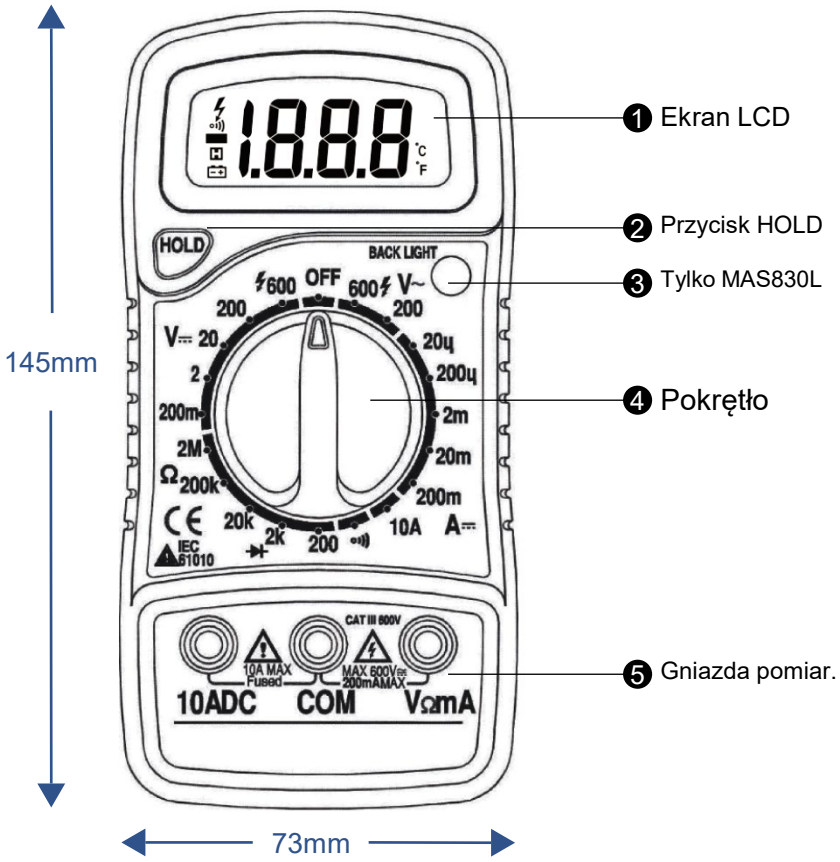

2. WYŻWIETLACZ LCD I SYMBOLE

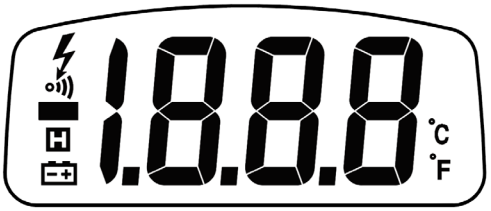

- Wysokość cyfr: 15 mm
  (7 segmentów)
- Maksymalne wskazanie: 1999
- Przekroczenie zakresu: symbol „I”
- Polaryzacja:
  znak „ ⊥” dla wartości ujemnej
- Częstotliwość odświeżania: 3 razy/s

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA – MAS838

Parametr	MAS838
Napięcie stałe (DC)	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V; do ±(0,8% + 2)
Napięcie przemienne (AC)	200 V / 600 V; ±(1,2% + 10)
Prąd stały (DC)	20 µA / 200 µA / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A; do ±(3,0% + 2)
Prąd przemienny (AC)	Nie
Rezystancja	200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ; do ±(1,0% + 2)
Pojemność	Nie
Częstotliwość	Nie
Temperatura	Nie
Maksymalne wskazanie	1999
Kategoria pomiarowa	CAT III 600 V
Wymiary wyświetlacza LCD	46 × 19 mm
Akustyczny test ciągłości	Tak
Test diod	Tak
Funkcja HOLD	Tak
Wskaźnik słabej baterii	Tak
Podświetlenie LCD	Nie
Podpórka	Tak
Zasilanie	1 bateria 9 V (6F22)
Wymiary	145 × 73 × 38 mm
Masa	ok. 240 g (bez baterii)



4. DANE OGÓLNE

Parametr	WartoŻŻ
Kategoria pomiarowa	CAT III 600 V
Stopień zanieczyszczenia	2
Wysokość pracy	poniżej 2000 m
Warunki pracy	0–40° C / 32–104° F (wilg. <80%, bez kondensacji)
Warunki przechowywania	−10–50° C / 14–140° F (wilg. <80%, bateria wyjęta)
Współczynnik temperaturowy	0,1 × dokładność znamionowa / ° C (<18° C lub >28° C)
Wskaźnik słabej baterii	Niski poziom baterii: symbol na ekranie
Kompatybilność EMC	EN 61326-1
Normy bezpieczeństwa LVD	EN 61010-1, EN 61010-031, EN 61010-033
Bezpieczniki	Bezpiecznik 1: F 250 mA/600 V Bezpiecznik 2: F 10 A/600 V
Zasilanie	1 bateria 9 V (6F22)
Wymiary/masa	145 (dł.) × 73 (szer.) × 38 (wys.) mm / ok. 240 g (bez baterii)

5. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Model	WyposaŻenie	IloŻŻ
MAS830	Multimetr cyfrowy	1 szt.
	Przewody pomiarowe	1 zestaw
	Instrukcja obsługi	1 szt.
	Bateria 9 V (6F22)	Brak w zestawie
	Pudełko	1 szt.

6. ZASTOSOWANIA

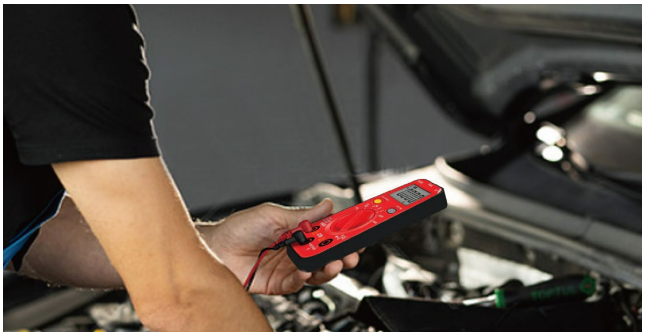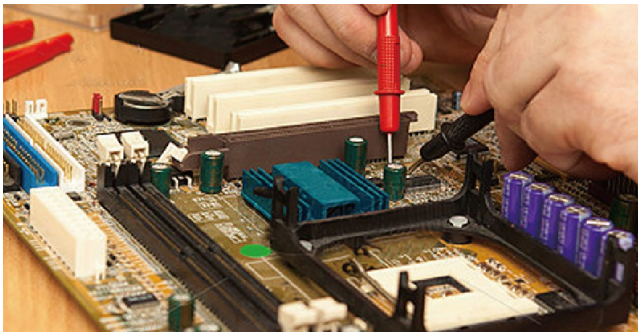
Więcej informacji o produktach V&A znajdziesz na naszej stronie:

www.vainstruments.com

Odwiedź nas na Facebooku i LinkedIn!

Producent:

Shanghai VA Instrument Co., Ltd.
Tel.: +86-21-69521064
e-mail: sales@vainstruments.com

Strefa A/D, 4. piętro, budynek 22
258 Yinlong Road, Waigang Town
Jiading, Szanghaj 201806, Chiny
www.vainstruments.com

Importer i dystrybutor:

LUMEL S.A.
Tel.: +48 68 45 75 100
e-mail: lumel@lumel.com.pl

ul. Słubicka 4
65-127 Zielona Góra, Polska
www.lumel.com.pl

*Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia